Veterinarian - Veterinärmedizin

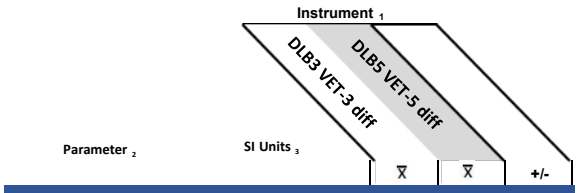

LOW / Blue cap				
LOT B0826L	Exp. Date: 2026-11-05 (YYYY-MM-DD)			
WBC	10^9/L or 10^3/mm^3	1,7	1,7	0,5
Lympho.	%	63	63	5
Mono.	%	6	6	5
Granulo.	%	31	-	5
Neutro.	%	-	30	5
Eosino.	%	-	1	0,5
RBC	10^{12}/L or 10^3/mm^3	2,40	2,40	0,2
HGB	g/dL	6,0	6,0	0,5
Hct	%	18,0	18,0	2
MCV	fL	75	75	4
MCHC	g/dL	33,3	33,3	4
MCH	pg	25,0	25,0	4
PLT	10^9/L or 10^3/mm^3	75	75	25
MPV	fL	8,2	8,2	2

NORMAL / Green cap				
LOT B0826N	Exp. Date: 2026-11-05 (YYYY-MM-DD)			
WBC	10^9/L or 10^3/mm^3	7,0	7,0	0,8
Lympho.	%	30	30	6
Mono.	%	5	5	5
Granulo.	%	65	-	7
Neutro.	%	-	59	7
Eosino.	%	-	6	2
RBC	10^{12}/L or 10^3/mm^3	4,65	4,65	0,2
HGB	g/dL	13,4	13,4	0,7
Hct	%	39,1	39,1	3
MCV	fL	84	84	4
MCHC	g/dL	34,3	34,3	4
MCH	pg	28,8	28,8	4
PLT	10^9/L or 10^3/mm^3	245	245	45
MPV	fL	8,2	8,2	2

HIGH / Red cap				
LOT B0826H	Exp. Date: 2026-11-05 (YYYY-MM-DD)			
WBC	10^9/L or 10^3/mm^3	19,0	19,0	2
Lympho.	%	13	13	7
Mono.	%	3	3	3
Granulo.	%	84	-	5
Neutro.	%	-	67	5
Eosino.	%	-	17	5
RBC	10^{12}/L or 10^3/mm^3	5,65	5,65	0,3
HGB	g/dL	17,9	17,9	0,9
Hct	%	51,4	51,4	3
MCV	fL	91	91	4
MCHC	g/dL	34,8	34,8	4
MCH	pg	31,7	31,7	4
PLT	10^9/L or 10^3/mm^3	490	490	65
MPV	fL	8,2	8,2	2

x̄	+ / -	1	2	3
Mean	Tolerance Limits	Instrument	Parameter	SI Units
Mittelwert	Toleranzgrenzen	Gerätetyp	Parameter	SI-Einheiten

Tolerance limits are guidelines for evaluating instrument data and account for instrument reproducibility and operator technique.
Die Toleranzgrenzen dienen als Richtlinien für die Bewertung der Gerätegenauigkeit und beinhalten die Geräte-Reproduzierbarkeit mitsamt Anwendungstechnik des Bedieners.

Human - Humanmedizin

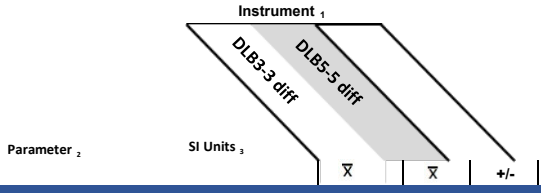

LOW / Blue cap				
LOT B0826L	Exp. Date: 2026-11-05 (YYYY-MM-DD)			
WBC	10^9/L or 10^3/mm^3	1,7	1,7	0,5
Lympho.	%	63	63	5
Mono.	%	6	6	5
Granulo.	%	31	-	5
Neutro.	%	-	30	5
Eosino.	%	-	1	0,5
RBC	10^{12}/L or 10^3/mm^3	2,40	2,40	0,2
HGB	g/dL	6,0	6,0	0,5
Hct	%	16,8	16,8	2
MCV	fL	70	70	4
MCHC	g/dL	35,7	35,7	4
MCH	pg	25,0	25,0	4
PLT	10^9/L or 10^3/mm^3	75	75	25
MPV	fL	8,2	8,2	2

NORMAL / Green cap				
LOT B0826N	Exp. Date: 2026-11-05 (YYYY-MM-DD)			
WBC	10^9/L or 10^3/mm^3	7,0	7,0	0,8
Lympho.	%	30	30	6
Mono.	%	5	5	5
Granulo.	%	65	-	7
Neutro.	%	-	59	7
Eosino.	%	-	6	2
RBC	10^{12}/L or 10^3/mm^3	4,65	4,65	0,2
HGB	g/dL	13,4	13,4	0,7
Hct	%	36,7	36,7	3
MCV	fL	79	79	4
MCHC	g/dL	36,5	36,5	4
MCH	pg	28,8	28,8	4
PLT	10^9/L or 10^3/mm^3	245	245	45
MPV	fL	8,2	8,2	2

HIGH / Red cap				
LOT B0826H	Exp. Date: 2026-11-05 (YYYY-MM-DD)			
WBC	10^9/L or 10^3/mm^3	19,0	19,0	2
Lympho.	%	13	13	7
Mono.	%	3	3	4
Granulo.	%	84	-	5
Neutro.	%	-	67	5
Eosino.	%	-	17	5
RBC	10^{12}/L or 10^3/mm^3	5,65	5,65	0,3
HGB	g/dL	17,9	17,9	0,9
Hct	%	48,6	48,6	3
MCV	fL	86	86	4
MCHC	g/dL	36,8	36,8	4
MCH	pg	31,7	31,7	4
PLT	10^9/L or 10^3/mm^3	490	490	65
MPV	fL	8,2	8,2	2

x̄	+ / -	1	2	3
Mean	Tolerance Limits	Instrument	Parameter	SI Units
Mittelwert	Toleranzgrenzen	Gerätetyp	Parameter	SI-Einheiten

Tolerance limits are guidelines for evaluating instrument data and account for instrument reproducibility and operator technique.
Die Toleranzgrenzen dienen als Richtlinien für die Bewertung der Gerätegenauigkeit und beinhalten die Geräte-Reproduzierbarkeit mitsamt Anwendungstechnik des Bedieners.

WARNING : Please check the MS Card type link to the used analyzer. WARNUNG : Bitte überprüfen Sie den MS Card-Typ-Link zu dem verwendeten Analysegerät.

WARNING : Opened tubes are stable for **14 days maximum**. WARNUNG : Geöffnete Röhrchen sind **maximal 14 Tage** lang stabil.

DIALAB Produktion und Vertrieb von chemisch-technischen Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H.
A – 2351 Wiener Neudorf, Austria, IZ NOE-Sued, Hondastrasse, Objekt M55 Phone: ++43 (0) 2236 660910-0, Fax: +43 (0) 2236 660910-30, e-mail: office@dialab.at